


医療廃棄物の分別方法

正しい分別をして、廃棄物の減量化に努めましょう

感染性廃棄物


※感染性廃棄物の詰めすぎは危険です
詰めすぎに注意してください

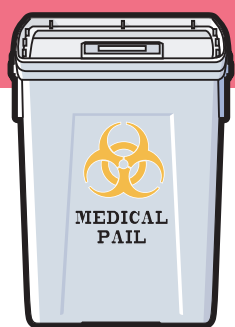

ペール缶



注射針

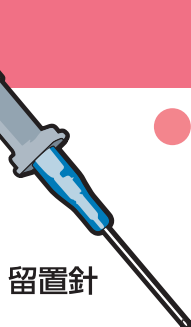

留置針


● 鋭利なもの（未使用も含む）



翼状針



メス

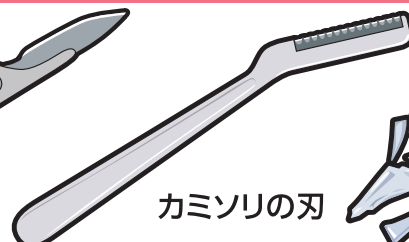


カミソリの刃




割れたガラス


● 血液・体液が付着した、もしくは付着したおそれのある全てのもの




ディスポ注射器




採血管

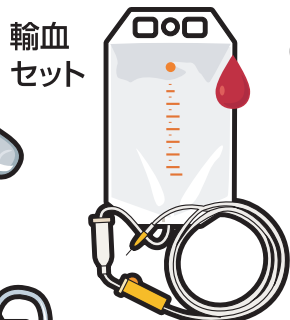


輸血セット




ガーゼ




ワイヤー

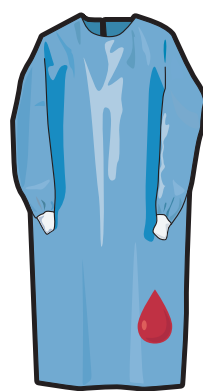

ディスポガウン




ディスポシート

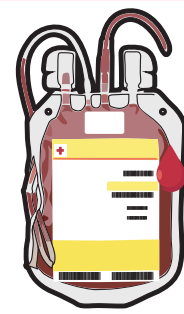


※血液製剤パック



吸引チューブ



バルンパック




カテーテル




グローブ



マスク




ペースメーカー



酒精綿

※血液製剤については、外見上血液と見分けがつかないため、血液等に該当する

● 透析器具

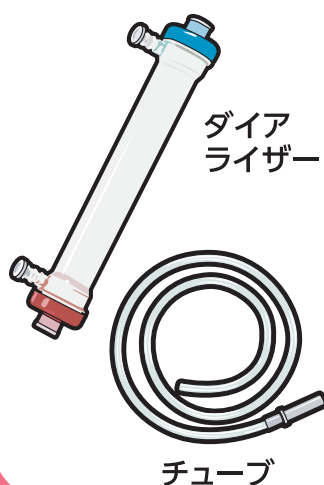


ダイアライザー

チューブ


● 感染症患者に使用したもの




おしり拭き



パット




紙おむつ




ディスポシート


● 検査等に用いたもの




尿コップ




シャーレ



培地



細菌検査の検体



試験紙

● その他



バイアルビン

(ガラス製の) アンプル



試験ビン

廃プラスチック類

● 血液・体液が付着していないプラスチック類




ギブス



ポリ容器



プラ製の空のアンプル

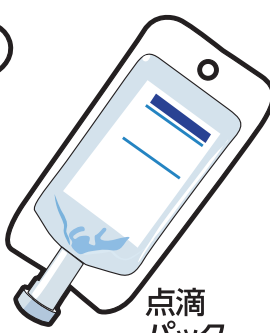

点滴パック

針・鋭利なもの・金属・ガラス類は厳禁
点滴パック・ポリ容器の中身は空にする

ビン類

● 100ccを超えるガラスビン（破損していないもの）



点滴ビン



薬ビン

ふた・プラスチックカバーは外す
中身の液体等は空にする



静医協

静岡県医師協同組合

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠3丁目6番3号

TEL. 054-246-0001 FAX. 054-248-0609 0120-149311

ホームページアドレス <http://www.ikyo.shizuoka.med.or.jp/>